

岡山大学機器管理システム  
操作マニュアル（利用者用）

イワミバイタル株式会社

# 目次

---

## 1 リユース機器

1.1	概要	-----	3
1.2	出品者（利用者ユーザ）の登録		
1.2.1	利用者ユーザの登録	-----	4
1.2.2	遊休機器を出品	-----	5
1.2.3	引き取り希望者との交渉	-----	6
1.2.4	引き取り先の決定	-----	7
1.2.5	リユース機器の承認確認、移動	-----	8
1.2.6	リユース機器情報の削除	-----	9
1.2.7	ユーザ情報の変更	-----	9
1.2.8	パスワードのリセット	-----	10

# 1 リユース機器


## 1.1 概要

このシステムではリユース機器の情報を管理します。

リユース機器の管理は、「岡山大学機器管理システム」にログインして行います。

岡山大学機器管理システム ログイン URL : <https://mypage.kikibun.okayama-u.ac.jp/users/login>

利用者は自分の登録したリユース機器の編集、削除をします。

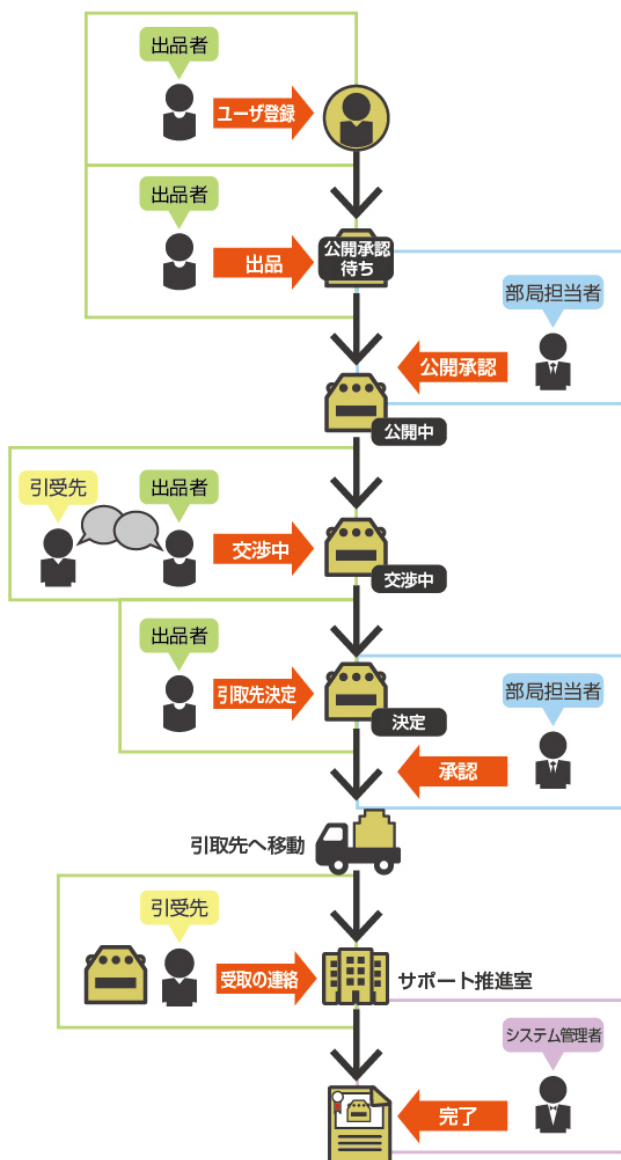

## 1.2 出品者（利用者ユーザ）の登録

### 1.2.1 利用者ユーザの登録

リユース機器を出品するための利用者ユーザを登録します。

1. 「岡山大学機器管理システム」のログイン画面から、「新規登録」をクリックします。



2. ユーザの情報を入力し、「登録」ボタンを押します。



3. 登録したメールアドレスに、ユーザ登録の確認メールが届きます。
4. メールに記載された URL にアクセスしてユーザ登録の手続きを完了します。登録手続のあとは管理者の承認を待ちます。

5. 管理者から登録を承認されるとユーザ登録が完了し、システムへログインできるようになります。

## 1.2.2 遊休機器を出品

不要になった機器をリユースシステムに出品します。出品する機器の情報を登録したら、部局担当者の決済へと自動で進みます。決済が下りれば、出品したリユース機器が公開されます。

1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
2. 「新規リユース機器」をクリックしてリユース機器の登録画面を表示します。



3. リユース機器の情報を入力します。

4. 「登録ボタン」を押してリユース機器を登録します。



- 登録後は部局担当者の決済へと進み、承認がされれば、リユース機器が公開されます。

### 1.2.3 引き取り希望者との交渉

リユース機器を出品後は、引き取り希望者からの連絡を待ちます。引き取り希望者から連絡があり、交渉を進めている場合は、状況を「交渉中」に変更します。

- 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
- 「リユース機器一覧」が表示されます。



- 引き取り先と交渉中の行の「編集」ボタンをクリックします。
- リユース状況の項目を「交渉中」にします。

- 画面下の「登録する」ボタンをクリックし、リユース機器の変更を保存します。

### 1.2.4 引き取り先の決定

リユース機器の引き取り先が決まったら、リユース情報の状況を「決定」に変更します。引き取り先が決定したリユース機器は自動で部局担当者の決済へ進みます。部局担当者から承認されれば、引き取り先へリユース機器を受け渡します。

- 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
- メニューから「機器」をクリックします。
- 「リユース機器一覧」が表示されます。

管理番号	画像	名称/規格	拠点名	取得年度	操作
EC4EC4		走査電子顕微鏡システム・332 FEI ELECTRON OPTICS 社製・QUANTA250 リユース		2009	編集 削除
EC3EC3		メチライサ システム Applied Biosystems · ABI310-3R genetic analyzer リユース 交渉中		2011	編集 削除

- 引き取り先が決定したリユース機器の行の「編集」ボタンをクリックします。
- リユース状況の項目を「決定」にします。

6. 画面下の「登録する」ボタンをクリックし、リユース機器の変更を保存します。

### 1.2.5 リユース機器の承認確認、移動

リユース機器の引き取り先の決定後、部局担当者の承認を確認します。リユースが承認されたらリユース機器を引き取り先へ移動（移設）します。移動が完了したら、リユース機器の引き取り先の方からサポート推進室に受取の完了を連絡します。

1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
2. 「リユース機器一覧」が表示されます。
3. 引き取り先が決定したリユース機器が「承認」されているかを確認します。

管理番号	画像	名称／規格	拠点名	取得年度	操作
EC4EC4		走査電子顕微鏡システム・332 FEI ELECTRON OPTICS 社製・QUANTA250 リユース		2009	編集 削除
EC3EC3		メチライサ システム Applied Biosystems · ABI310-3R genetic analyzer リユース 承認		2011	編集 削除

1 of 1

Copyright ©2017 Okayama University. All rights reserved.

4. 承認されている場合は、リユース機器を移動（移設）します。
5. 移動（移設）が完了したら、引き取り先からサポート推進室へ受取の完了を連絡します。



## 1.2.6 リユース機器情報の削除

1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
2. 「リユース機器一覧」が表示されます。
3. 削除したいリユース機器の行の右端の「削除」ボタンをクリックします。



4. 確認ダイアログが表示されます。「OK」ボタンを押して削除します。



## 1.2.7 ユーザ情報の変更

メールアドレス、電話番号など、ユーザ情報が変更になった場合はユーザ情報を変更します。

1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
2. メニューの左端の「(ユーザ名)」→「ユーザ情報」をクリックします。



3. ユーザ情報の編集画面が表示されます。
4. ユーザ情報の項目を編集します。
5. 画面下の「登録」ボタンをクリックし、ユーザ情報の変更を保存します。



## 1.2.8 パスワードの変更

1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
2. メニューの左端の「(ユーザ名)」 → 「パスワード変更」をクリックします。



3. 現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（確認用）を入力し、「登録」ボタンを押します。

共同利用機器・リユース機器  
機器情報

機器 user ▾

### ユーザ

新しいパスワードを入力して下さい。

パスワード

新しいパスワード

新しいパスワード (確認用)

**登録**

Copyright ©2017 Okayama University. All rights reserved.