

岡山大学機器管理システム  
操作マニュアル（利用者用）

# 目次

1. リユース機器.....	3
1.1 概要.....	3
1.2 利用者ユーザ.....	4
1.2.1 利用者ユーザの登録.....	4
1.2.2 ユーザ情報の変更.....	5
1.2.3 パスワードの変更.....	5
1.3 リユース機器.....	6
1.3.1 遊休機器を出品.....	6
1.3.2 引き取り希望者との交渉.....	8
1.3.3 引き取り先の決定.....	9
1.3.4 リユース機器の承認確認、移動.....	10
1.3.5 リユース機器情報の削除.....	11

# 1. リユース機器


## 1.1 概要

このシステムではリユース機器の情報を管理します。

リユース機器の管理は、「岡山大学機器管理システム」にログインして行います。

岡山大学機器管理システム ログインURL : <https://mypage.kikibun.okayama-u.ac.jp/users/login>

利用者は自分の登録したリユース機器の編集、削除をします。

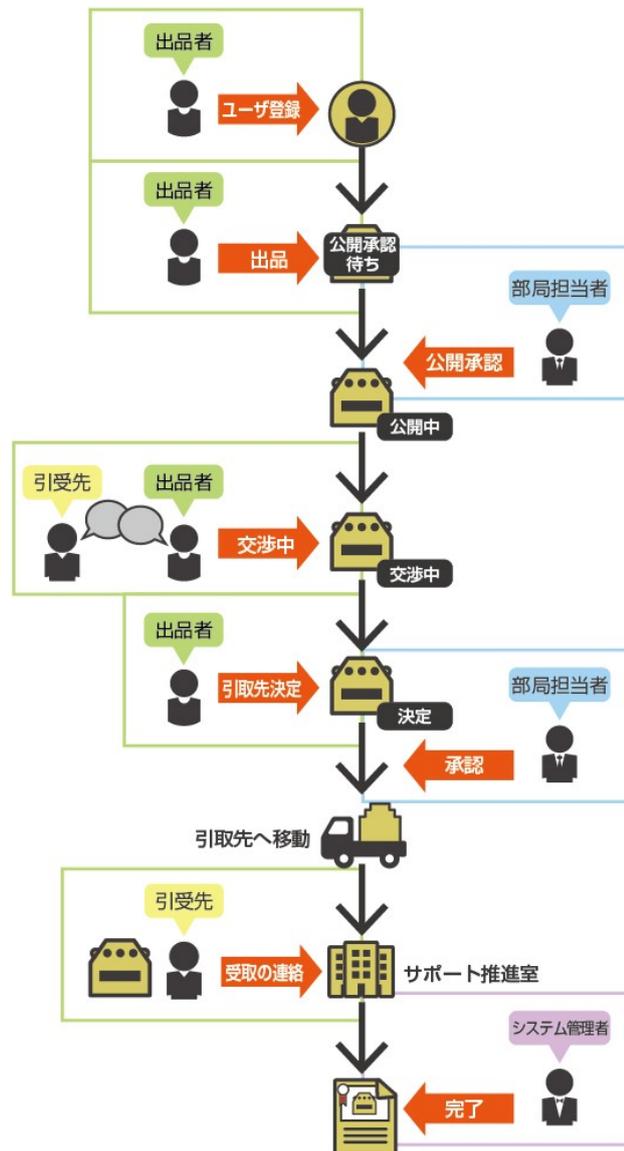

## 1.2 利用者ユーザ

### 1.2.1 利用者ユーザの登録

リユース機器を出品、リユース要望の登録をするための利用者ユーザを登録します。

1. 「設備・技術サポート推進室」のリユースの利用案内のページから、「ご登録はこちらから」をクリックします。



2. ユーザの情報を入力し、「登録」ボタンを押します。

The screenshot shows the 'New User Registration' (ユーザー新規登録) form on the 'Shared Equipment and Reusable Equipment Information' (共同利用機器・リユース機器 機器情報) website. The form includes the following fields:

- ユーザ名 (Username): abc\_user
- メールアドレス (Email Address): abc@user.com
- パスワード (Password): [masked]
- パスワード(確認用) (Password Confirmation): [masked]
- 姓 (Surname): 岡山
- 名 (First Name): 太郎

A '登録' (Register) button is located at the bottom of the form.

3. 登録したメールアドレスに、ユーザ登録の確認メールが届きます。
4. メールに記載された URL にアクセスしてユーザ登録の手続きを完了します。登録手続のあとは管理者の承認を待ちます。

5. 管理者から登録を承認されるとユーザ登録が完了し、システムへログインできるようになります。

## 1.2.2 ユーザ情報の変更

メールアドレス、電話番号など、ユーザ情報が変更になった場合はユーザ情報を変更します。

1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
2. メニューの左端の「(ユーザ名)」→「ユーザ情報」をクリックします。

共同利用機器・リユース機器  
機器情報

### リユース機器

管理番号	画像	名称/規格	拠点名	取得年度	操作
EC4EC4		走査電子顕微鏡システム・332 FEI ELECTRON OPTICS 社製・QUANTA250 リユース		2009	編集 削除
EC3EC3		メチライサ システム Applied Biosystems ・ABI310-3R genetic analyzer リユース 承認		2011	編集 削除

1 of 1

3. ユーザ情報の編集画面が表示されます。
4. ユーザ情報の項目を編集します。
5. 画面下の「登録」ボタンをクリックし、ユーザ情報の変更を保存します。

共同利用機器・リユース機器  
機器情報

### ユーザ

ユーザ名

メールアドレス

姓

名

所属

電話番号

登録

Copyright ©2017 Okayama University. All rights reserved.

## 1.2.3 パスワードの変更

1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
2. メニューの左端の「(ユーザ名)」→「パスワード変更」をクリックします。

共同利用機器・リユース機器  
機器情報

機器 user ▾

ユーザ情報  
パスワード変更  
ログアウト

## リユース機器

管理番号	画像	名称/規格	拠点名	取得年度	操作
EC4EC4		走査電子顕微鏡システム・332 FEI ELECTRON OPTICS 社製・QUANTA250 リユース		2009	編集 削除
EC3EC3		メテライサシステム Applied Biosystems ・ABI310-3R genetic analyzer リユース 承認		2011	編集 削除

3. 現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード（確認用）を入力し、「登録」ボタンを押します。

共同利用機器・リユース機器  
機器情報

機器 user ▾

## ユーザ

新しいパスワードを入力して下さい。

パスワード

新しいパスワード

新しいパスワード（確認用）

登録

Copyright ©2017 Okayama University. All rights reserved.

## 1.3 リユース機器

### 1.3.1 遊休機器を出品

不要になった機器をリユースシステムに出品します。出品する機器の情報を登録したら、部局担当者の決済へと自動で進みます。決済が下りれば、出品したリユース機器が公開されます。

1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
2. 「新規リユース機器」をクリックしてリユース機器の登録画面を表示します。

## リユース機器

新規 リユース機器

管理番号 画像 名称/規格 拠点名 取得年度 操作

1 of 1

Copyright ©2017 Okayama University. All rights reserved.

- リユース機器の情報を入力します。

## リユース機器

学内公開\*  非公開  公開

### 基本情報

管理番号\*

ここにヘルプを表示できます

名称\*

規格\*

メーカー・型式

取得年度\*

### リユース

リユース状況  募集中  決定  交渉中  終了  廃棄

リユース前設置場所

リユース後所属・設置場所

リユース後用途

詳細URL

提供者氏名

- 「登録する」ボタンを押してリユース機器を登録します。

残り使用可能年数

装置を利用した研究例

その他

登録する

Copyright ©2017 Okayama University. All rights reserved.

- 登録後は部局担当者の決済へと進み、承認がされれば、リユース機器が公開されます。

## 1.3.2 引き取り希望者との交渉

リユース機器を出品後は、引き取り希望者からの連絡を待ちます。引き取り希望者から連絡があり、交渉を進めている場合は、状況を「交渉中」に変更します。

1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
2. 「リユース機器一覧」が表示されます。

共同利用機器・リユース機器  
機器情報

機器 user

### リユース機器

新規 リユース機器

管理番号	画像	名称/規格	拠点名	取得年度	操作
EC3EC3		メチライサ システム Applied Biosystems ・ ABI310-3R genetic analyzer リユース		2011	編集 削除
EC4EC4		走査電子顕微鏡システム・332 FEI ELECTRON OPTICS 社製・QUANTA250 リユース		2009	編集 削除

1 of 1

Copyright ©2017 Okayama University. All rights reserved.

3. 引き取り先と交渉中の行の「編集」ボタンをクリックします。
4. リユース状況の項目を「交渉中」にします。

共同利用機器・リユース機器  
機器情報

機器 user

### リユース機器

削除 決定

学内公開\*  非公開  公開

#### 基本情報

管理番号\* EC3EC3

ここにヘルプを表示できます

名称\* メチライサ システム

規格\* Applied Biosystems ・ ABI310-3R genetic analyzer

#### リユース

リユース状況  募集  決定  交渉中  終了  廃棄

リユース前設置場所

リユース後所属・設置場所

リユース後用途

詳細URL

提供者氏名\* 本瀬 宏康

5. 画面下の「登録する」ボタンをクリックし、リユース機器の変更を保存します。

## 1.3.3 引き取り先の決定

リユース機器の引き取り先が決まったら、リユース情報の状況を「決定」に変更します。引き取り先が決定したり

ユース機器は自動で部局担当者の決済へ進みます。部局担当者から承認されれば、引き取り先へリユース機器を受け渡します。

1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
2. 「リユース機器一覧」が表示されます。

管理番号	画像	名称/規格	拠点名	取得年度	操作
EC4EC4		走査電子顕微鏡システム・332 FEI ELECTRON OPTICS 社製・QUANTA250 リユース		2009	編集 削除
EC3EC3		メチライサ システム Applied Biosystems・ABI310-3R genetic analyzer リユース 交渉中		2011	編集 削除

3. 引き取り先が決定したリユース機器の行の「編集」ボタンをクリックします。
4. リユース状況の項目を「決定」にします。

学内公開\*  非公開  公開

**基本情報**

管理番号\*  ここにヘルプを表示できます

名称\*

規格\*

**リユース**

リユース状況  募集中  決定  交渉中  終了  廃棄

リユース前設置場所

リユース後所 屋・設置場所

リユース後用途

5. 画面下の「登録する」ボタンをクリックし、リユース機器の変更を保存します。

### 1.3.4 リユース機器の承認確認、移動

リユース機器の引き取り先の決定後、部局担当者の承認を確認します。リユースが承認されたらリユース機器を引き取り先へ移動（移設）します。移動が完了したら、リユース機器の引き取り先の方からサポート推進室に受取の完了を連絡します。

1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。

- 「リユース機器一覧」が表示されます。
- 引き取り先が決定したリユース機器が「承認」されているかを確認します。

共同利用機器・リユース機器  
機器情報

機器 user ▾

### リユース機器

新規 リユース機器

管理番号	画像	名称/規格	拠点名	取得年度	操作
EC4EC4		走査電子顕微鏡システム・332 FEI ELECTRON OPTICS 社製・QUANTA250 <a href="#">リユース</a>		2009	<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>
EC3EC3		メチライサ システム Applied Biosystems ・ ABI310-3R genetic analyzer <a href="#">リユース</a> <a href="#">承認</a>		2011	<a href="#">編集</a> <a href="#">削除</a>

1 of 1

Copyright ©2017 Okayama University. All rights reserved.

- 承認されている場合は、リユース機器を移動（移設）します。
- 移動（移設）が完了したら、引き取り先からサポート推進室へ受取の完了を連絡します。

### 1.3.5 リユース機器情報の削除

1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
2. 「リユース機器一覧」が表示されます。
3. 削除したいリユース機器の行の右端の「削除」ボタンをクリックします。



4. 確認ダイアログが表示されます。「OK」ボタンを押して削除します。

